


Giri frese da 50 a 200 g/min


- Torque inserimento 20-30
- Torque serraggio 70-80
- Torque serraggio vite definitiva 25

I suggerimenti relativi all'utilizzo dei diversi impianti nei siti è puramente indicativo. La scelta finale spetta al clinico in base allo spessore e durezza dell'osso.


Frese Physioplant




● CONO 3.3

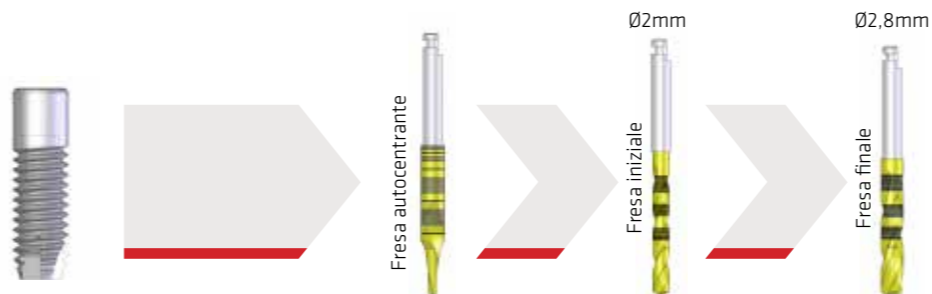


● CONO 3.75

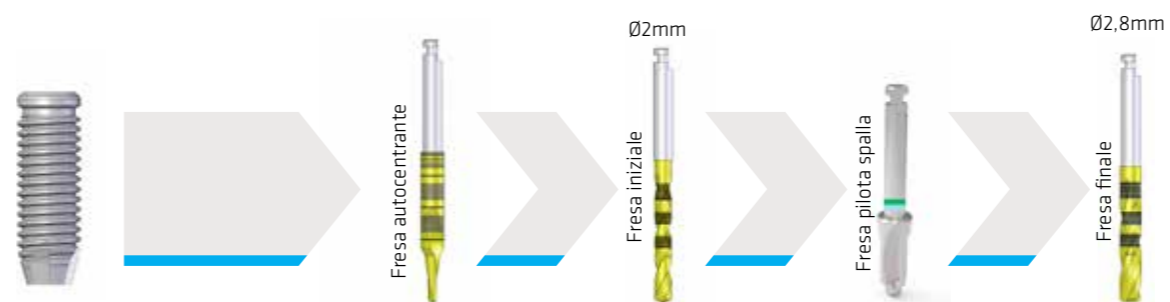

● CONO 4

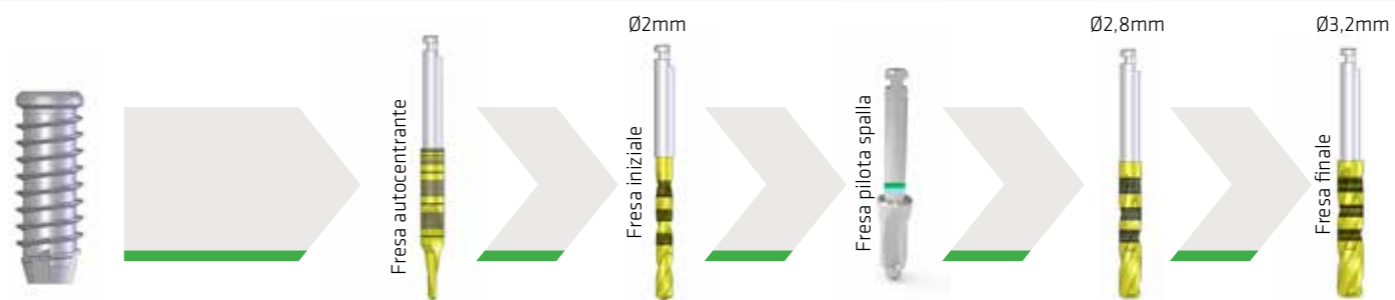

● CONO 5*

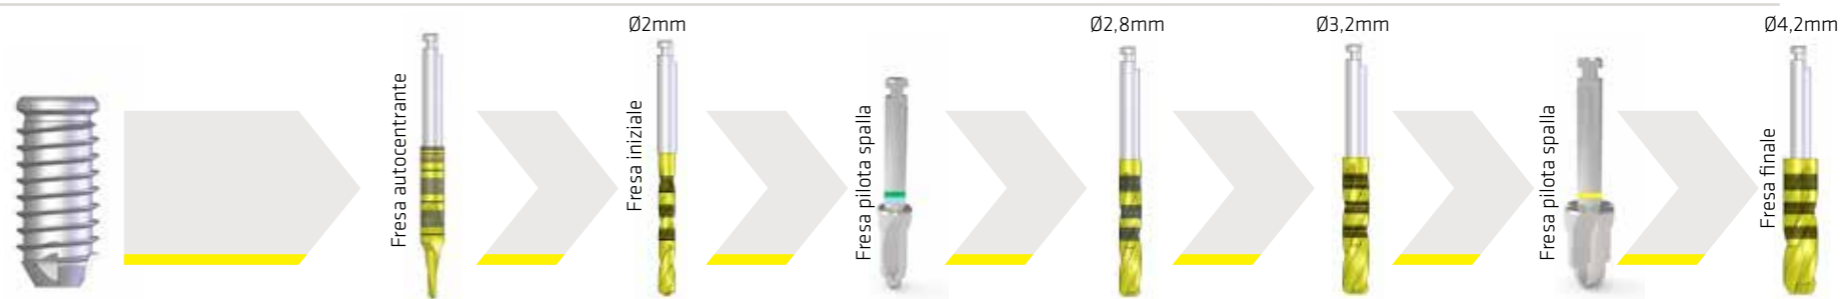

*Controindicato per osso D1